




Messprotokoll:	ILK-B-33-Muster	Temperatur:	20 ± 1 °C
Datum:	06.03.2019	rel. Feuchte:	70 ± 2 %
Bearbeiter:	Holfeld	Volumenstrom:	50 m³/h

Prüfling:	Musterfilter	Prüfgas:	Zyklohexan
Hersteller:	Mustermann	CAS-Nr.:	110-82-7
Kommentar:	-		
Abmessungen (Ø x H):	190 x 275 mm		

Prüfergebnisse:

Temperatur:	19,5 °C	Konzentration:	504 ppm
rel. Feuchte:	69,6 %	Anströmgeschw.:	0,12 m/s
Volumenstrom, mittel:	50,0 m³/h		
Messzeit:	76 min	Durchbruch nach:	75 min
		Speicherkapazität:	150,4 g

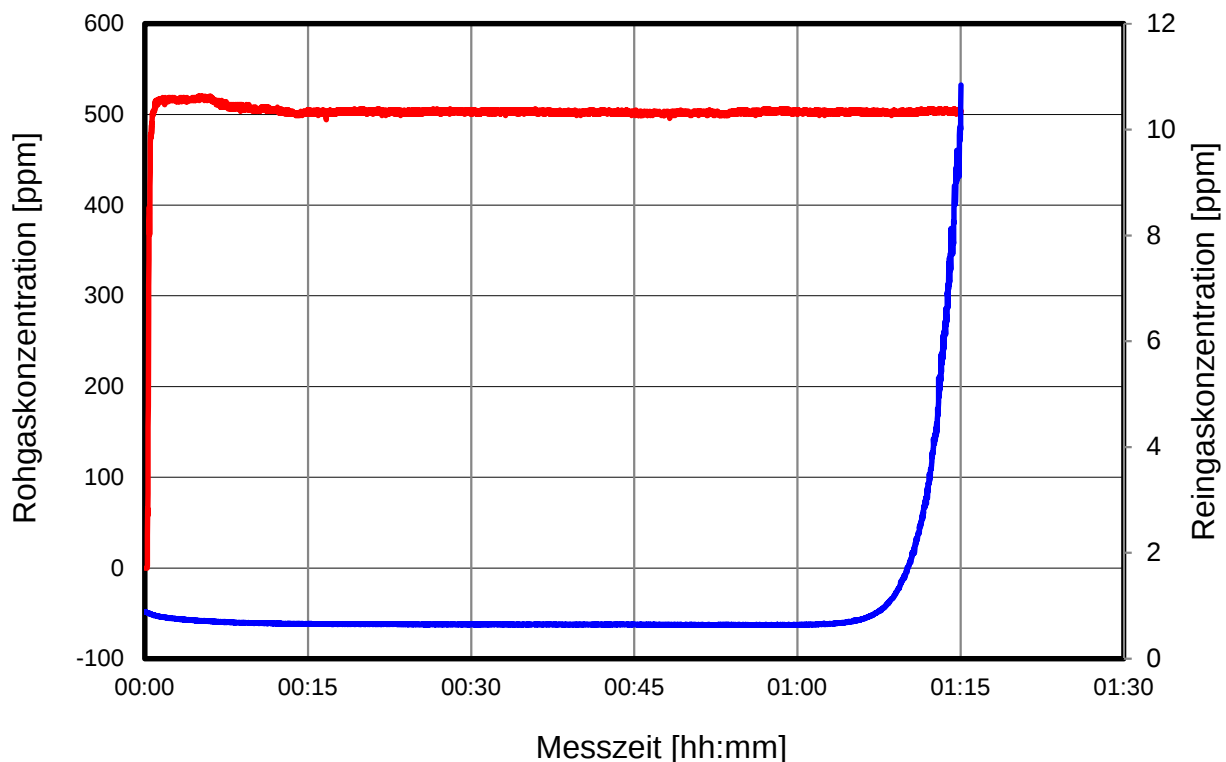Zyklohexan-Konzentrationsverläufe:

Max. zulässige Reingaskonzentration während der gesamten Prüfung über 70 min
nach (DIN EN 15695-2:2009) 10 ppm

Der Filter erfüllt bezüglich seiner Abscheideleistung gegenüber Zyklohexan
die Anforderungen der Prüfvorschrift

Seite 1 von 1



Messprotokoll:	ILK-B-33-Muster	Temperatur:	20 ± 1 °C
Datum:	26.11.2018	rel. Feuchte:	70 ± 2 %
Bearbeiter:	Holfeld	Volumenstrom:	50 m ³ /h

Prüfling:	Musterfilter	Prüfgas:	Zylohexan
Hersteller:	Mustermann	CAS-Nr.:	110-82-7
Kommentar:	-		
Abmessungen:	190 x 275 mm		


bis zum Durchbruch:

dos. Prüfgasmasse: 150,46 g

Speicherkapazität: 150,44 g

Durchbruch nach: 75 min

Zylohexan-Durchbruchskurve:

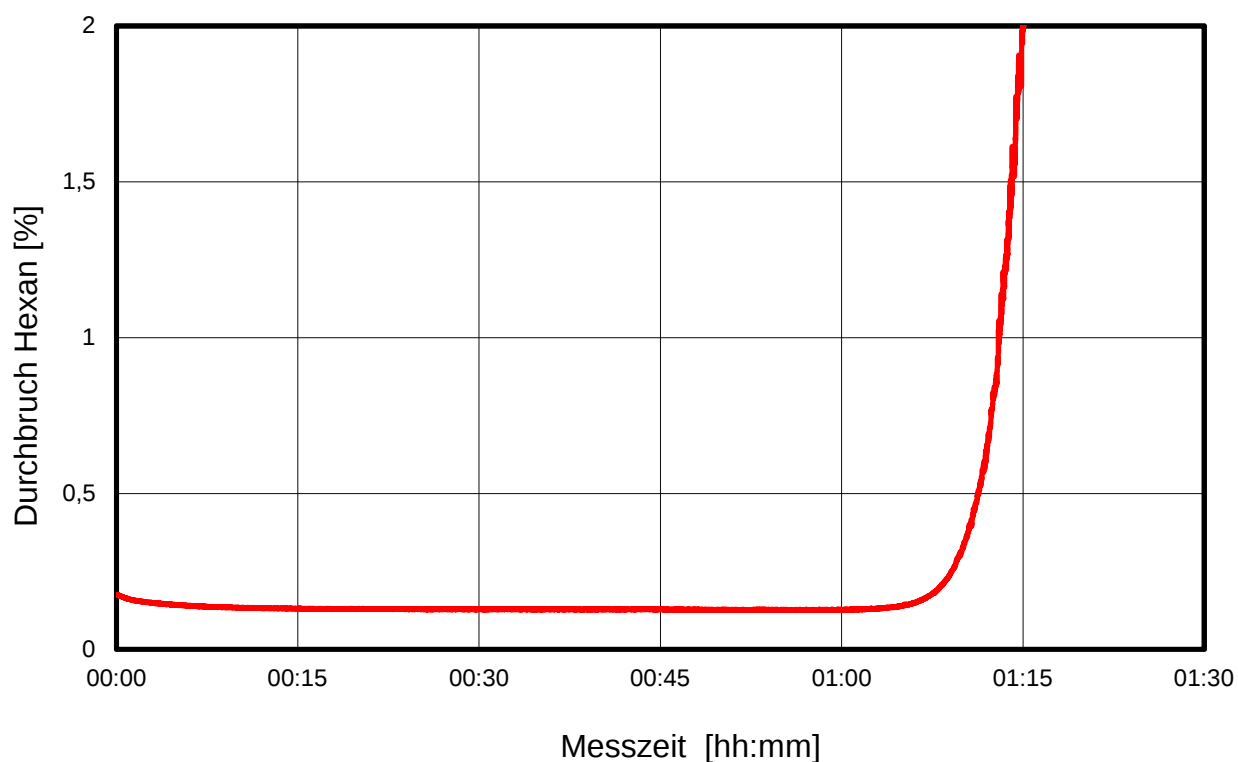



Messprotokoll:	ILK-B-33-Muster
Datum:	15.11.2018
Bearbeiter:	Holfeld

Prüfling:	Musterfilter	01
------------------	--------------	----

Hersteller:	Mustermann
Kommentar:	-
Abmessungen:	190 x 275 mm

Differenzdruckkurve:

